

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱A冷藏區

時間區間: 2026-05-01 00:00 ~ 2026-05-31 23:59

最大值: 4.8 °C

最小值: 4.2 °C

平均值: 4.5 °C

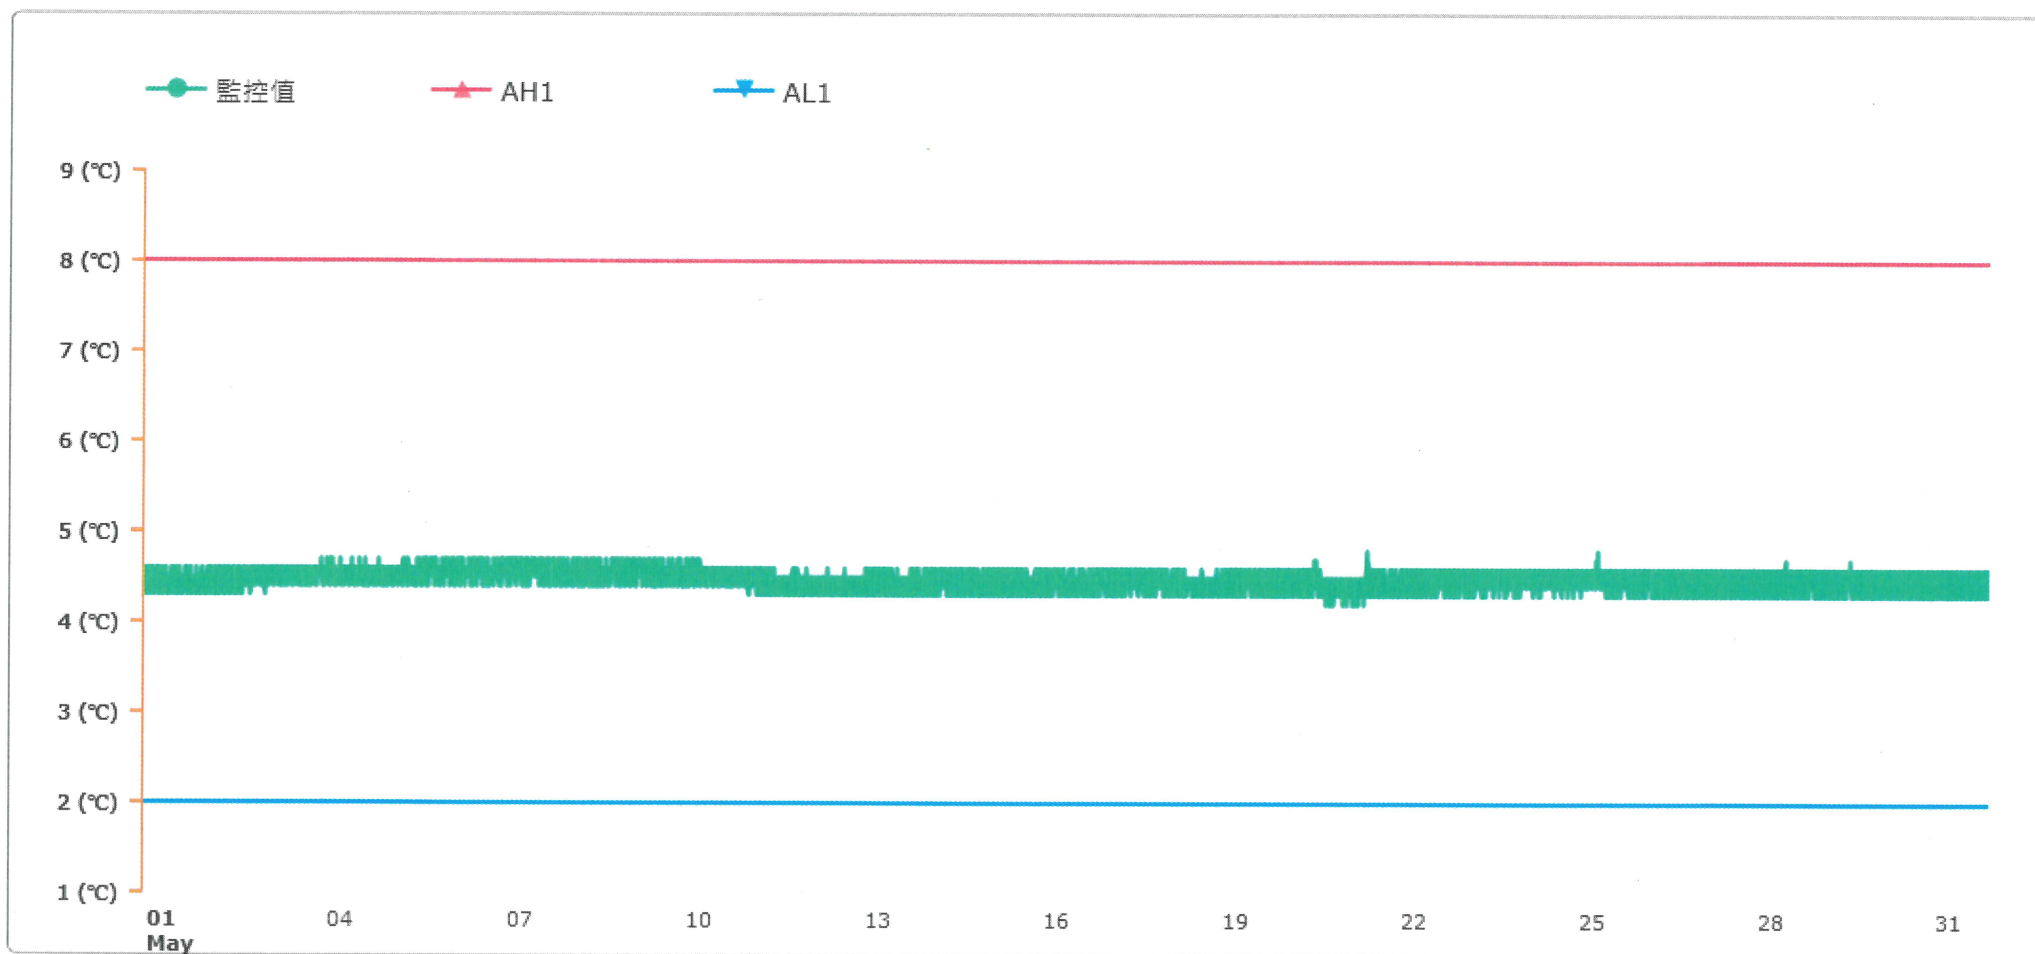

製表者: 丁鈺龍 Yu-Lung Ding 01 Jun 2026

單位主管: Sin-Yi Huang 01 Jun 2026