

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱A冷藏區

時間區間: 2026-06-01 00:00 ~ 2026-06-30 23:59

最大值: 4.7 °C

最小值: 4.2 °C

平均值: 4.5 °C

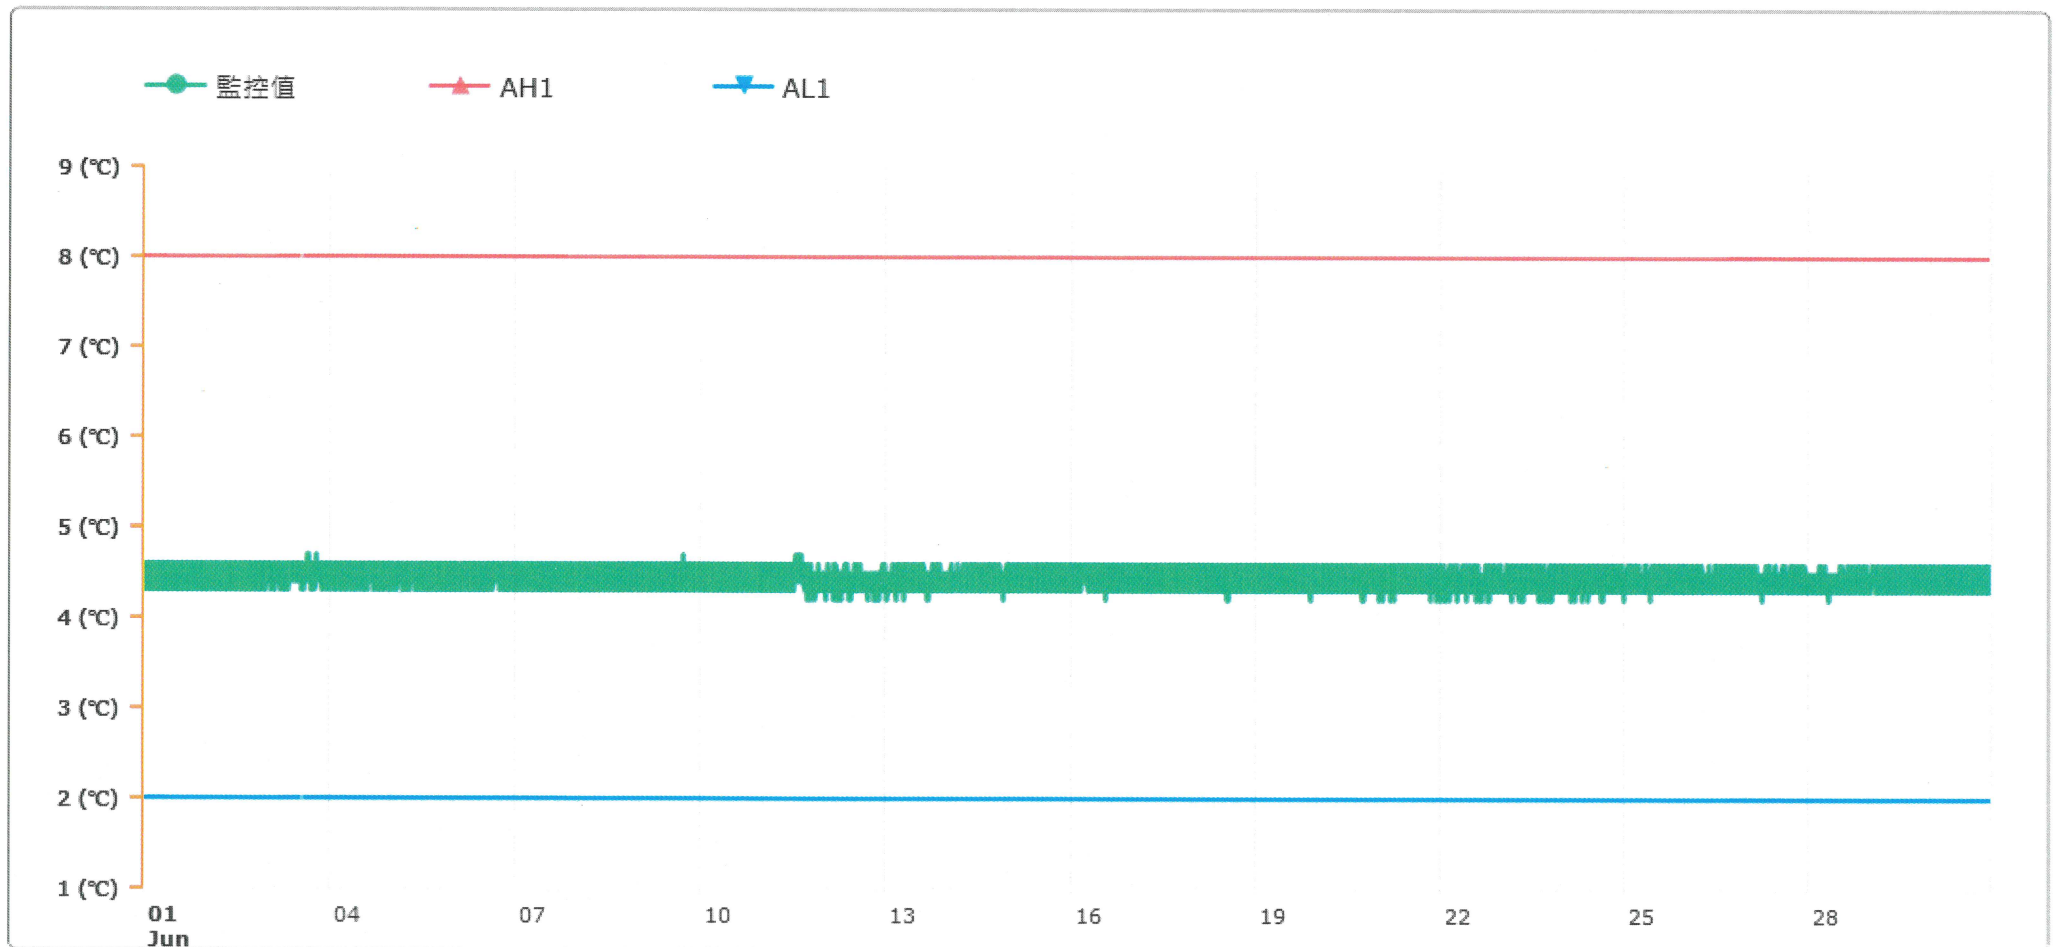

製表者: 丁鈺龍 Yu-Long Ding 02 Jul 2026

單位主管: Sin-Yi Huang 02 Jul 2026