

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱A冷藏區

時間區間: 2026-08-01 00:00 ~ 2026-08-31 23:59

最大值: 5.1 °C

最小值: 4.2 °C

平均值: 4.5 °C

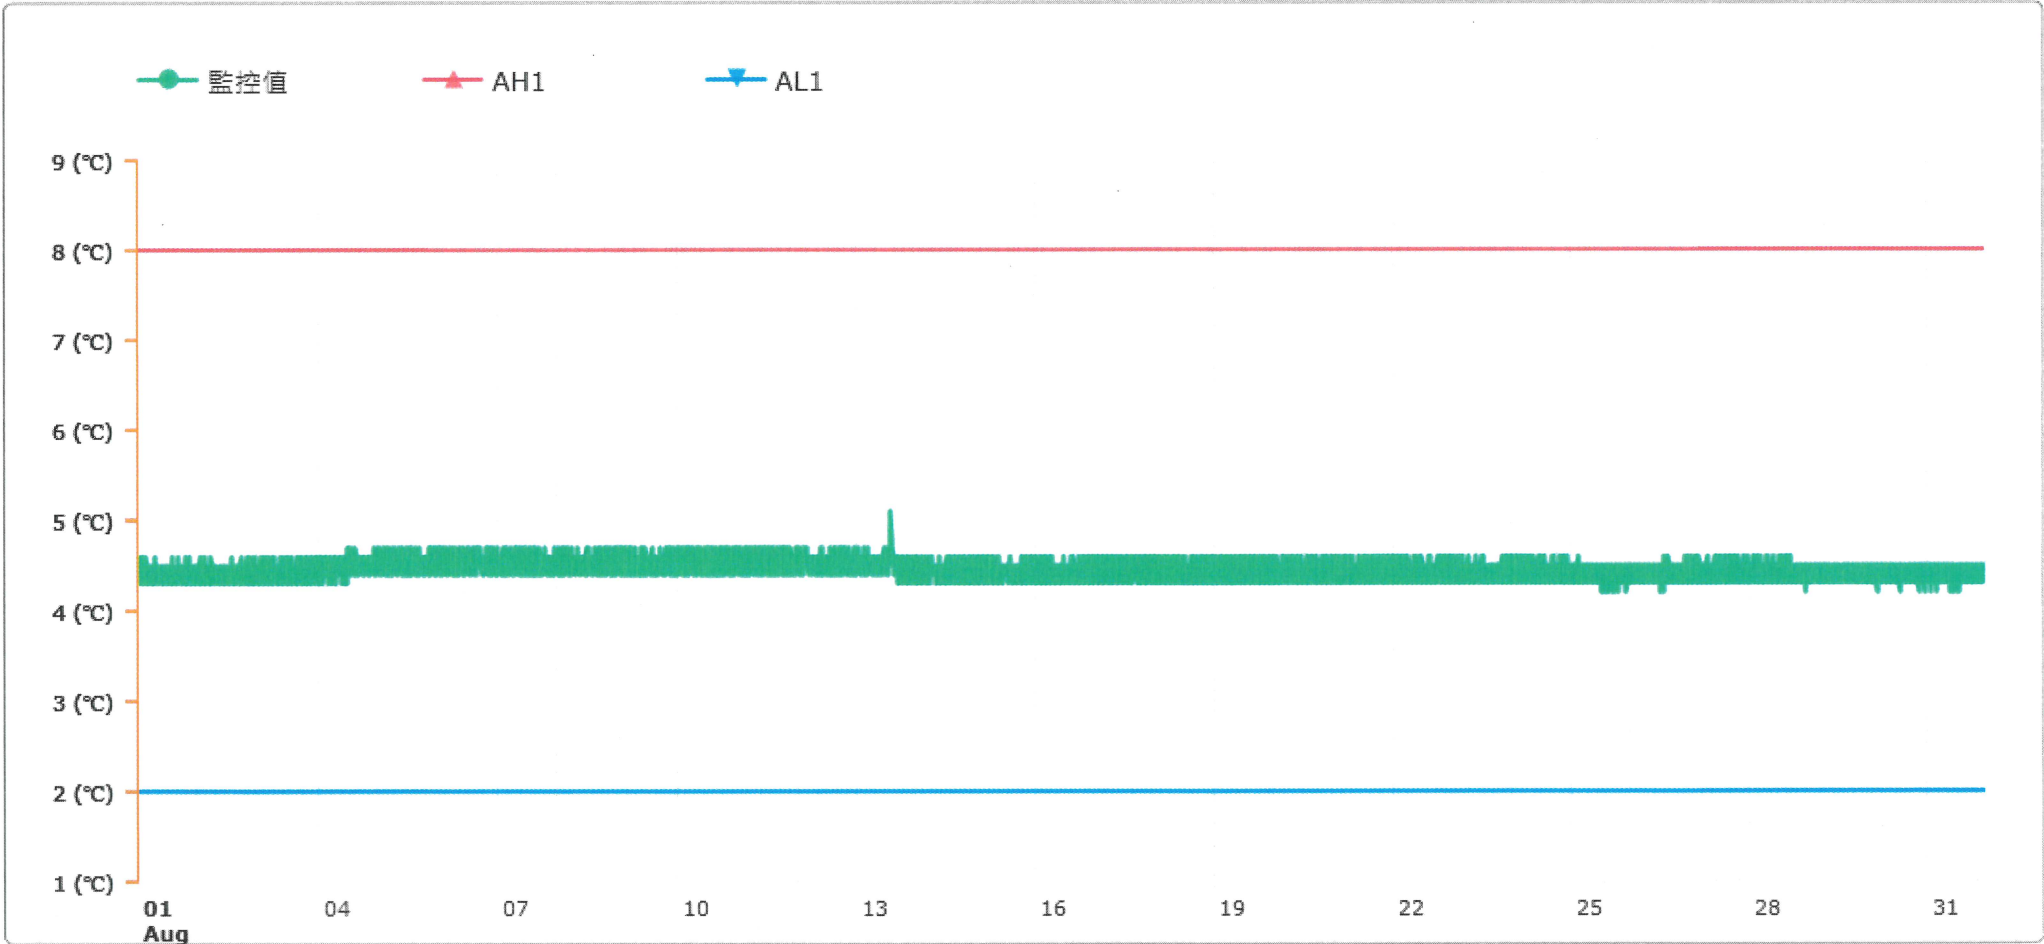

製表者: 丁鈺龍 Yu-Long Ding 01 Sep 2026

單位主管: Sin-Yi Huang 01 Sep 2026