

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-06-01 00:00 ~ 2026-06-30 23:59

最大值: 65.4 %RH

最小值: 31.4 %RH

平均值: 45.1 %RH

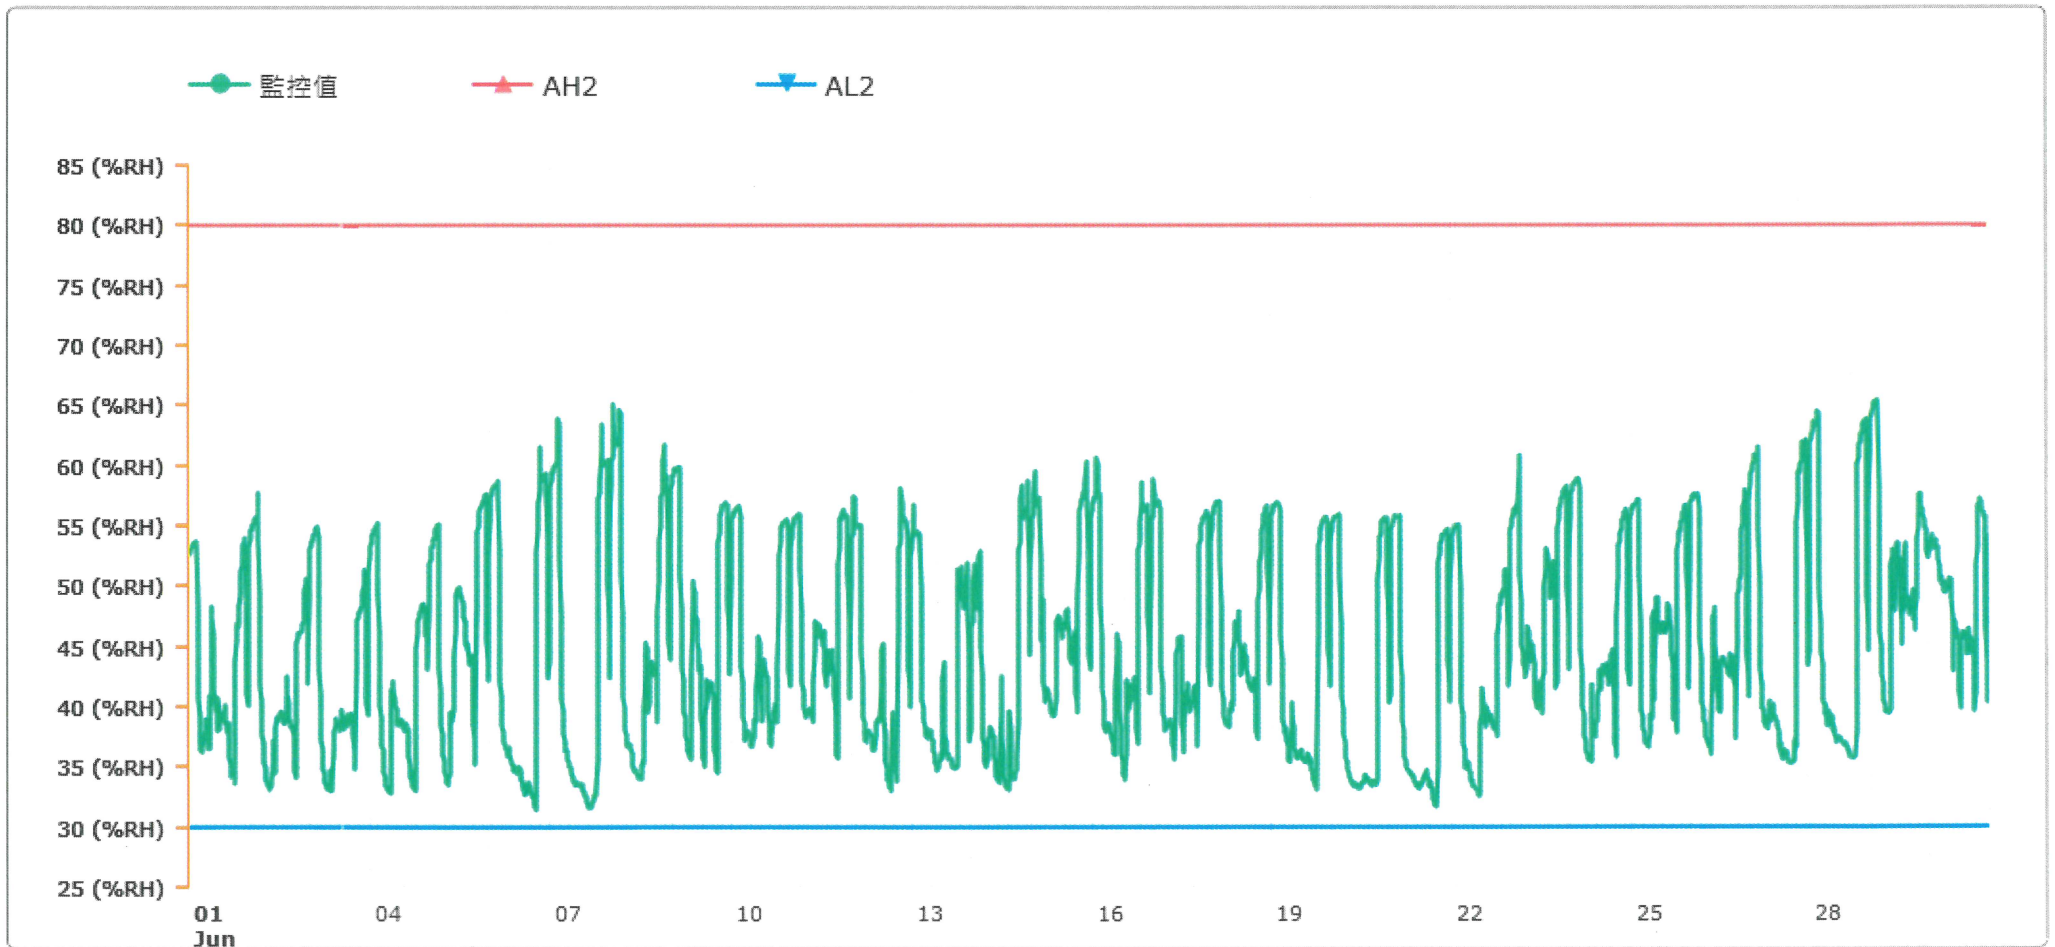

製表者: 丁鈺龍 Yu-long Ding 02 Jul 2026

單位主管: Sin-yi Hung 02 Jul 2026