

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-07-01 00:00 ~ 2026-07-31 23:59

最大值: 80 %RH

最小值: 35.5 %RH

平均值: 54.1 %RH

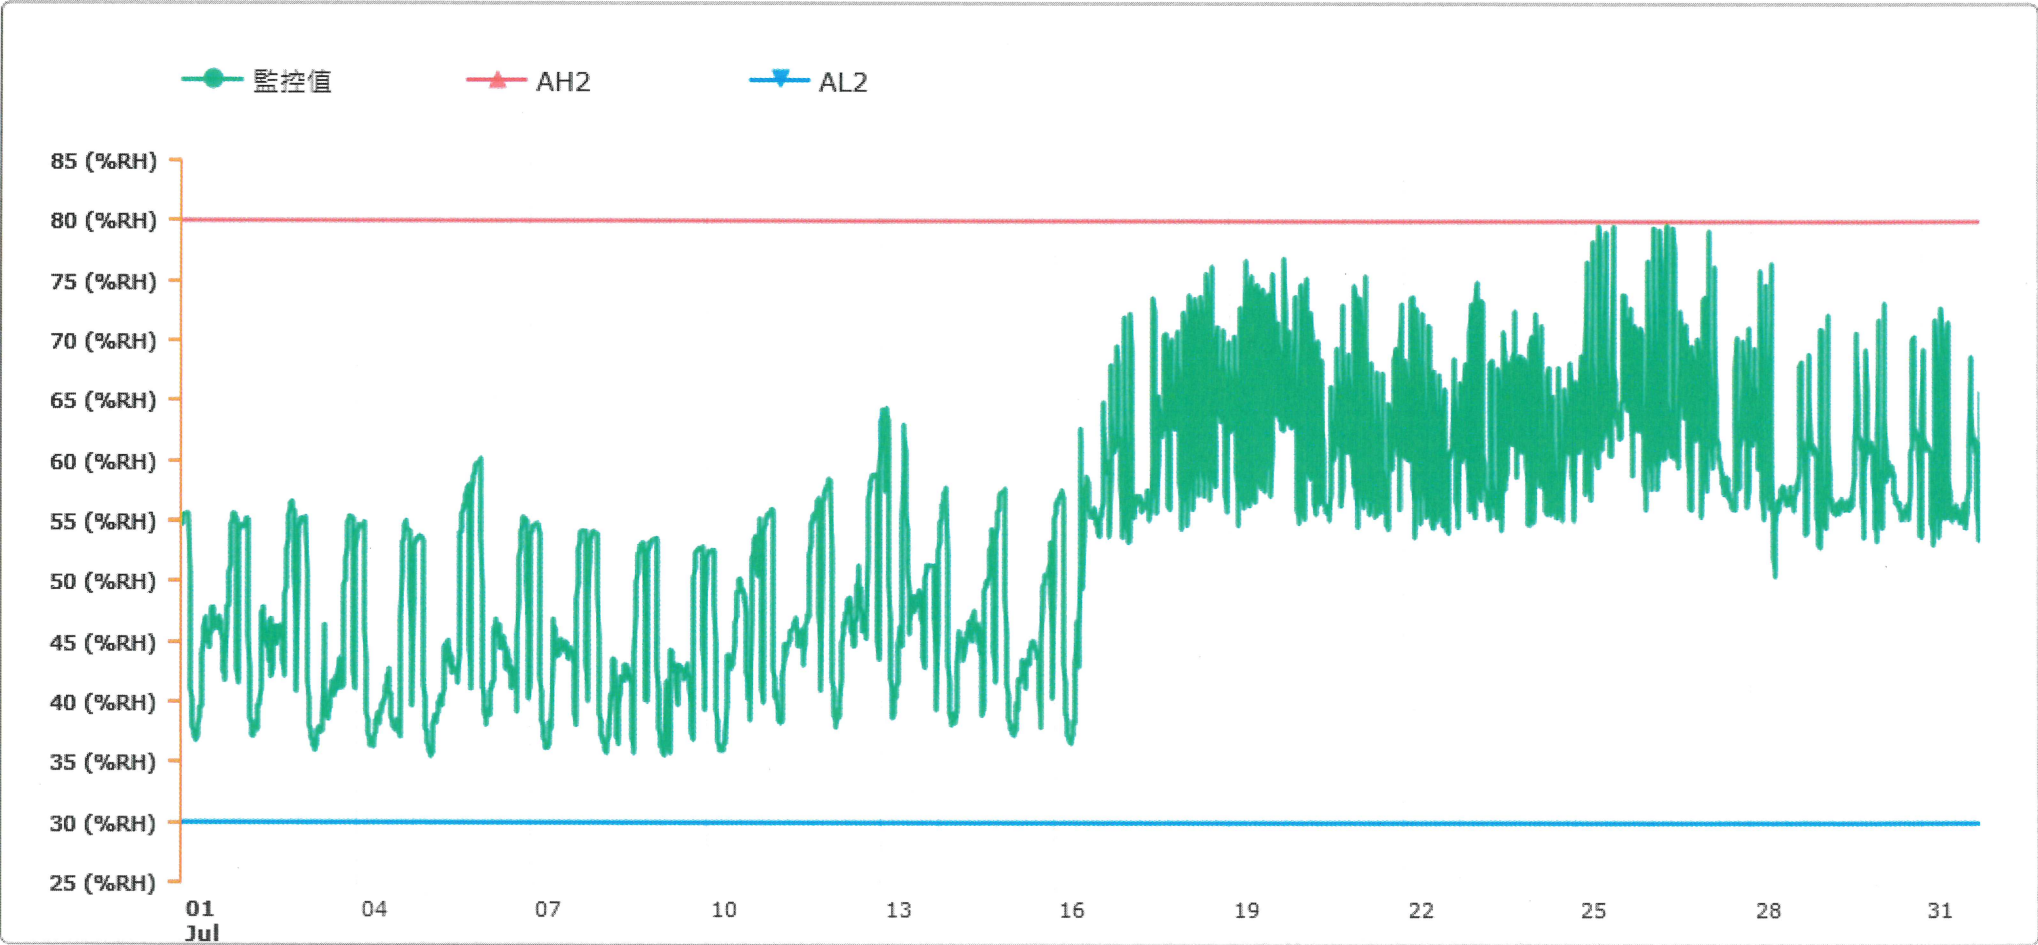

製表者: 丁鈺龍 Yu-Long Ding 03 Aug 2026

單位主管: Sin-Y. Huang 03 Aug 2026