

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-08-01 00:00 ~ 2026-08-31
23:59

最大值: 75.8 %RH

最小值: 46.8 %RH

平均值: 59.6 %RH

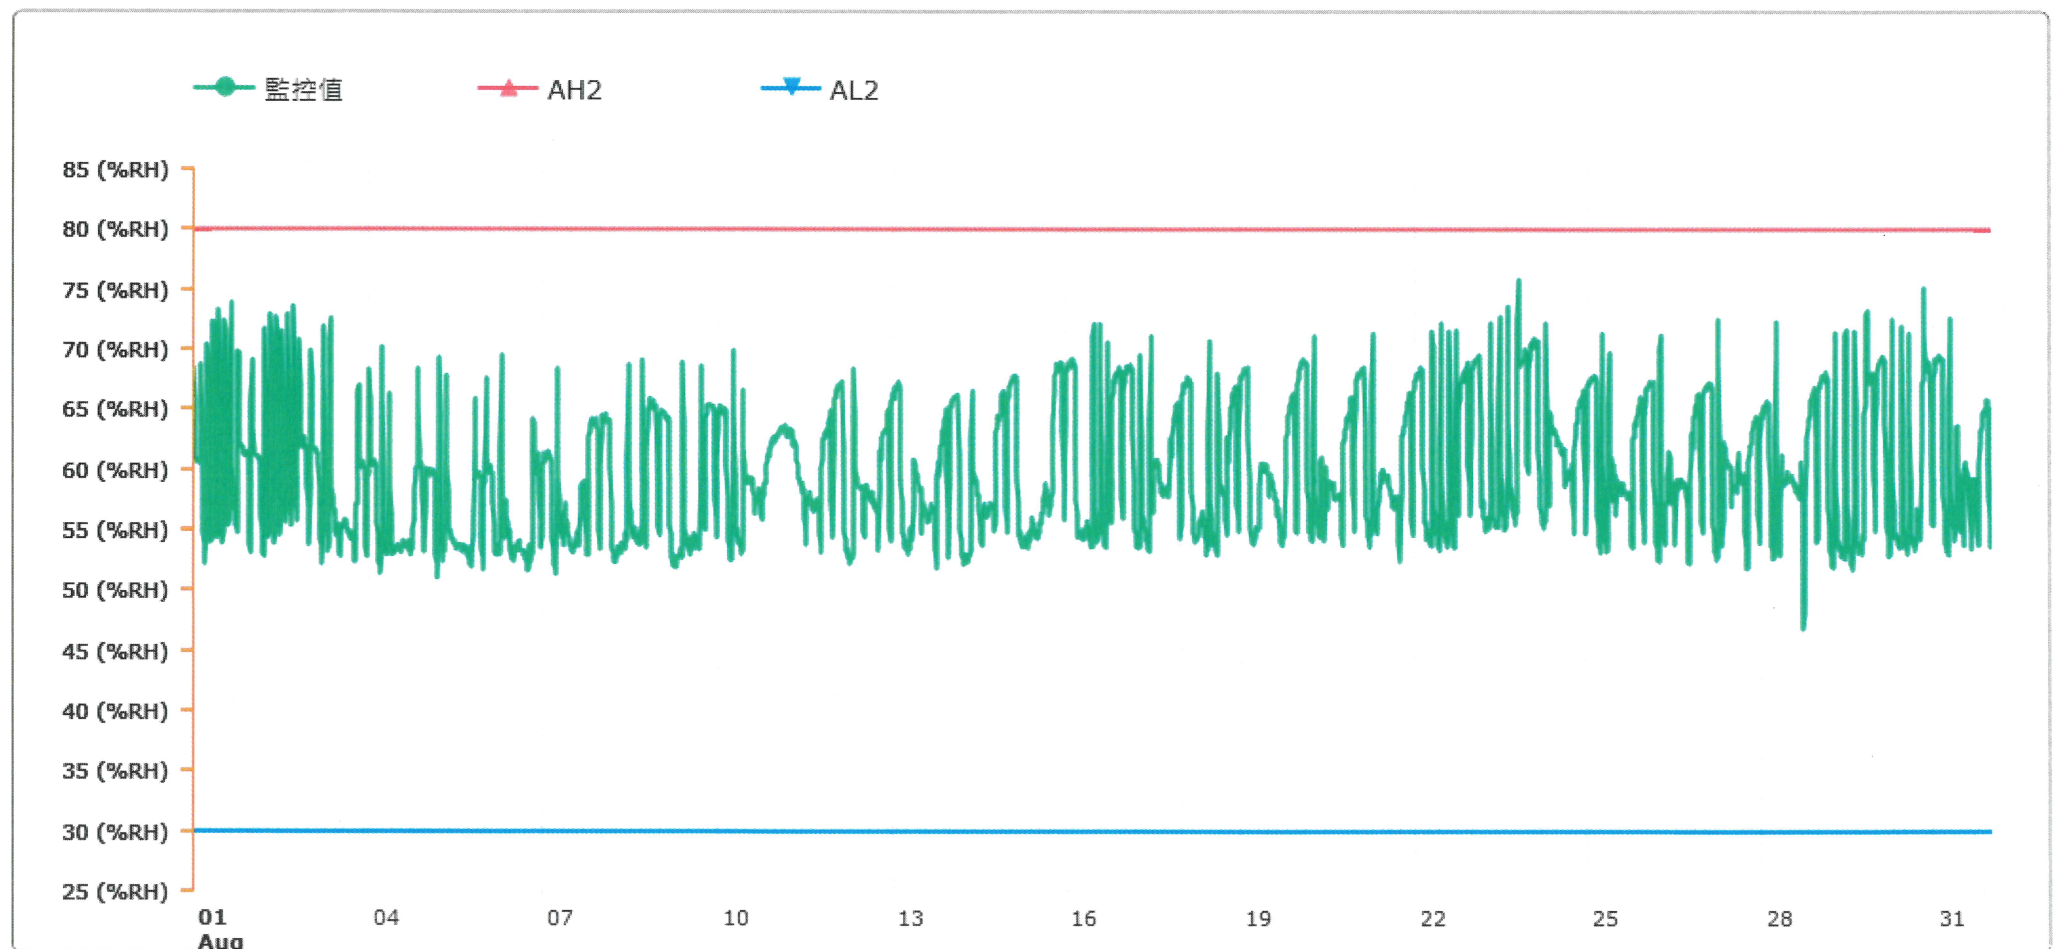

製表者: 丁鈺龍 Yu-Lung Ding 01 Sep 2026

單位主管: Sin-Y. Huang 01 Sep 2026