


供應中心

單位介紹



護理長1位、股長3位

技術員：一般技術員7位、特殊技術員16位、清潔員：1位

年資15
年以上 **53%**



第一種壓力容器證照74%




高壓滅菌鍋6台、電漿滅菌鍋1台

負責全院滅菌、玉里及關山慈濟醫院電漿滅菌、消防局器械滅菌

滅菌服務量64686件/月

單位環境

雲端環境溫度監測系統

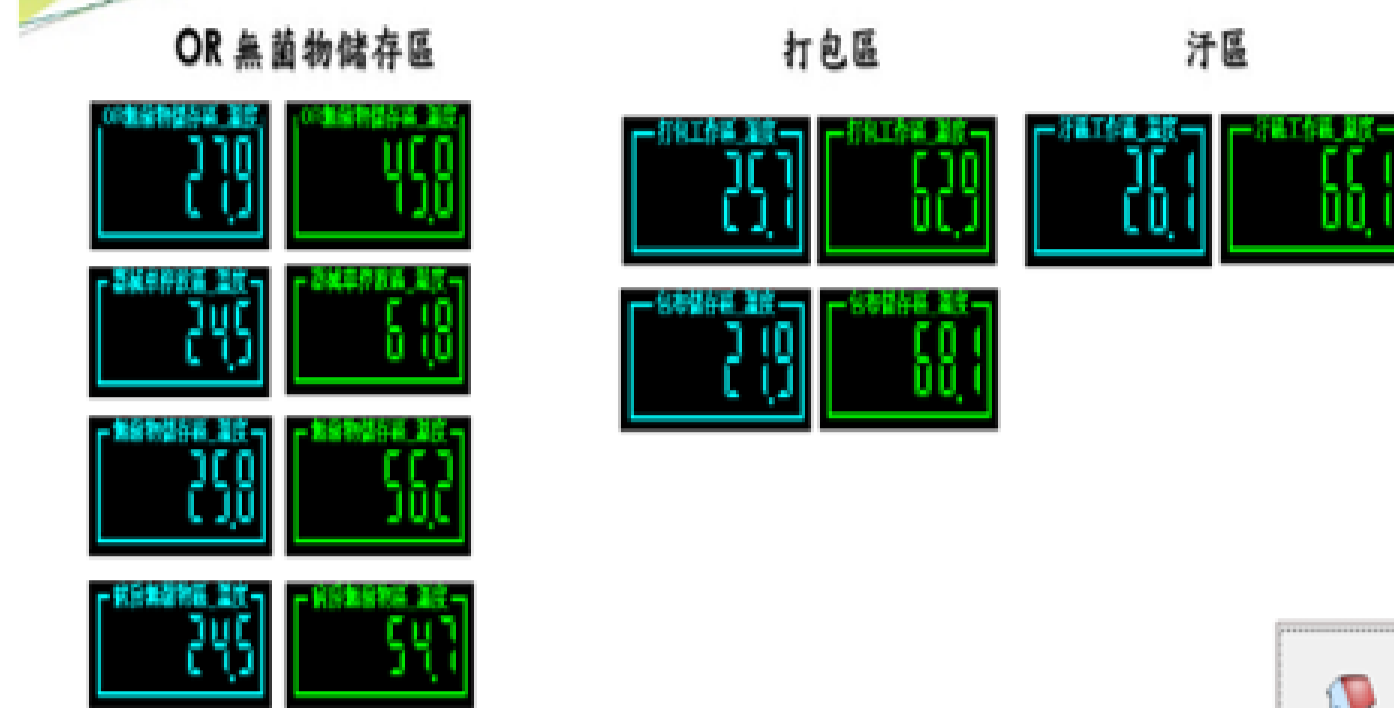

供應中心_溫溼度監測系統

動線—平面圖




服務內容及規範



- BNCB0C316 高壓滅菌鍋操作作業標準
- BNCB0C317 EO GAS滅菌作業標準
- BNCB0C318 低溫電漿滅菌作業標準
- BNCB0C320 全院奇換消毒滅菌作業標準
- BNCB0C321 污洗區作業標準
- BNCB0C322 無菌物品配送作業標準
- BNCB0C326 儲存區備手術器械、皿作業標準
- BNCB0C328 生物培養作業標準
- BNCB0C330 包裝區作業標準
- BNCB0C334 滅菌異常作業標準
- BNCB0C345 器械查檢作業標準
- BNCB0C421 奇售手術器械管理規定
- BNCB0C402 供應中心服裝管理規定

確實的滅菌監測


高壓滅菌

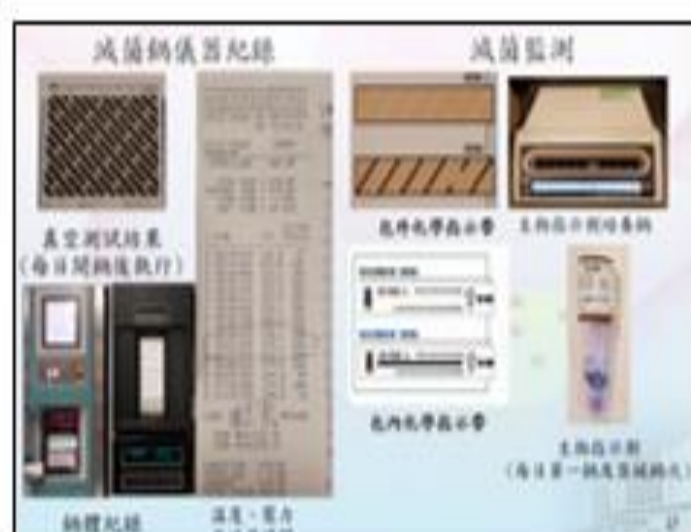

電漿滅菌




EO滅菌

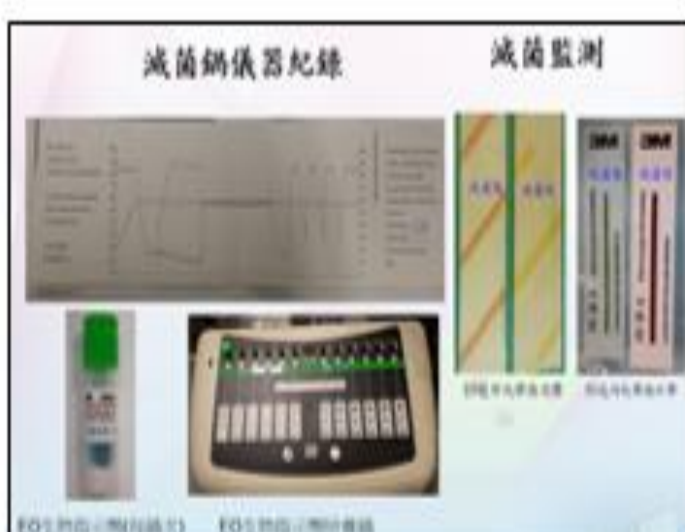

優質的品質確效

清潔品質

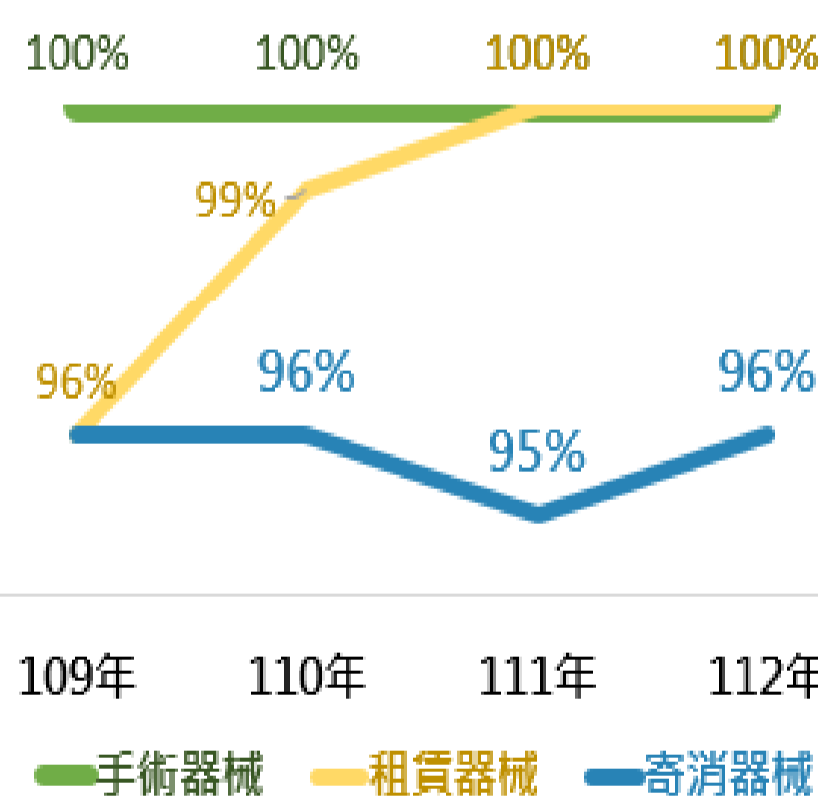

滅菌品質

滅菌物品質確效通過率
109-112年執行生物培養34751次

100%

滅菌物品到期日品質確效通過率

109-112年抽測無菌物品送微生物培養檢驗共564件

100%

品質保證

品質，是我們追求的唯一目標

優化供應中心作業流程及環境，深獲疾管署肯定



人因化
目視化



品質，是我們追求的唯一目標

降低手術器械裸消率

110-111年長期未使用
手術器械包盤重新整合

↓60%

降低手術器期到重滅菌率



111-112年
院內品質
改善計畫

佳作